# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

*64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2*

*tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info*

*CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10* *BDO 000082299*


L. Dz. ZPDK/11/20/33/21

Oborniki, dnia 17.03.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/11/20

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1xużytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych,** ogłoszonego w dniu 29.12.2020r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

**1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 69 pkt. 1 i 2 pętle o długości 240 cm?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli długości 240 cm.**

**2. Dot: Pakietu nr 20, poz. 1-6, 8**
W związku z wprowadzeniem nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™, które zastępuje dotychczas stosowane połączenia EnLock, prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 w poz. 1-6, 8 zgłębniki, zestawy i strzykawki z końcówką ENFIT.
Przejście z dotychczasowego systemu EnLock na obowiązujące połączenia EnFit jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu dla złączy z otworami o małej średnicy, zwanych ENFit™.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zgłębników, zestawów i strzykawek z końcówką ENFit.**

**3.** dot.: Pakietu nr 20, poz. 1
W związku z wycofaniem rozmiaru Ch 8/130, czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie wyspecyfikowanego zgłębnika dostępnego w rozmiarach CH8/110cm, Ch10/110cm, Ch12/110cm, Ch10/130cm, Ch6/60cm do wyboru przez Zamawiającego?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgłębnika o wyżej wymienionych rozmiarach. Wybór nastąpi wg bieżących potrzeb.**

4. **Dot: Pakietu nr 20, poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 pozycja 5 oczekuje zestawu do gastrostomii endoskopowej zakładanego metodą pull pod kontrolą endoskopu gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe (min 30 dni). Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu, bez PCV.

Zakończony złączem ENFit, wyposażony w zacisk do regulacji przepływu?

Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SIWZ.

Połączenie EnFit zastępuje dotychczas stosowane połączenia EnLock. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do gastrostomii endoskopowej zakładanego metodą pull pod kontrolą endoskopu gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe (min 30 dni). Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu, bez PCV. Zakończony złączem ENFit, wyposażony w zacisk do regulacji przepływu.**

5. **Dot: Pakietu nr 20, poz. 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 pozycja 8 wymaga strzykawki jednorazowego użytku przeznaczonej do żywienia enteralnego z końcówką ENFit 60ml, niecentycznej? Strzykawka niecentryczna z końcówką ENFit gwarantuje szczelność z zestawami do podaży diet dojelitowych stosowanych przez Zamawiającego oraz maksymalne wykorzystanie płynów pobranych do strzykawki.

Połączenie EnFit zastępuje dotychczas stosowane połączenia EnLock. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki o wyżej opisanych parametrach.**

6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 8 nożyczki preparacyjne METZENBAUM tępo-tępe?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 15 pensetę chirurgiczną o długości 14,5 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

8. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 18** pean o długości 21 cm Fig.1 lub pean 18,5 cm w kształcie litery S?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 20 pean o długości 27 cm?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 32 kosz perforowany o wymiarach 310x190x65 mm?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 33 przykrycie do kosza o wymiarach 310x190 mm ?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

12. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 34** matę silikonową o wymiarach 440x230 mm z możliwością docięcia na odpowiedni wymiar?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

13. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 35 kleszczyki o długości 12,5 cm?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

14. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 41 nożyczki METZENBAUM-NELSON tępo-ostre?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.**

15. **Pakiet nr 25**
Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego o długości 25m w stanie nierozciągniętym?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego wyżej rękawa.**

16. **Pakiet nr 25**
Pozycje 4-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazę pakowaną pojedynczo?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy pakowanej pojedynczo.**

17. **Pakiet nr 25**
Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej 13 nitkowej o szerokości 90 cm?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy opisanej wyżej.**

18. **Pakiet nr 25**
Pozycja 18 i 19. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5 metrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. odpowiednio: poz. 18 – 1 520 sztuk i poz. 19 – 4 000 sztuk?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek o długości 5m w ilości jak podano wyżej.**

**19. Dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

**20. Pakiet nr 42**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne grupy asortymentowe.**

**21. Pakiet nr 42, Gr. I, poz. 1-46**

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną wchłanialną, plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie całkowitego wchłaniania 60-90 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 80%, po 3 tygodniach 50%, po 4 tygodniach 20%?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania nici zgodnie z opisem w SIWZ.**

**22. Pakiet nr 42, Gr. I, poz. 27, 32**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „czarna", pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania szwu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**23. Pakiet nr 42, Gr. II, poz. 47-54**

Czy Zamawiający dopuści monofilament wchłanialny, polidioksanon, okres podtrzymywania tkankowego po 43 dniach 55-60%, całkowity czas wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania monofolamentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**24. Pakiet nr 42, Gr. II, poz. 47-54**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania nici zgodnie z opisem w SIWZ.**

**25. Pakiet nr 42, Gr. II, poz. 47-50, 53**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania szwu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**26. Pakiet nr 42, Gr. IV, poz. 83**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania igły zgodnie z opisem w SIWZ.**

**27. Pakiet nr 42, Gr. V, poz. 86-93**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny pleciony, zbudowany z polidioksanonu, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania szwu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**28. Pakiet nr 45, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania szwu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Formularz Cenowy Pakiet nr 79:**

**29.** dotyczy poz.30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 30 do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert ponieważ wiele firm oferujących narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne nie posiada w swojej ofercie specjalistycznych narzędzi laparoskopowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**30. dotyczy poz.32:**

Czy zamawiający dopuści kosz perforowany ze stali nierdzewnej o wymiarze **243x240x70mm**, pozostałe parametry bez zmian?

Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 32 do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kosza o wyżej podanym wymiarze oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**31.** dotyczy poz.33

Czy zamawiający dopuści przykrycie do kosza o wymiarze **244x243** mm kompatybilne z koszem 243x240x70mm ,reszta parametrów bez zmian?Jeśli to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie poz.33 do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kosza o wyżej podanym wymiarze oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**32.** dotyczy poz.34

Czy zamawiający dopuści matę silikonową o wymiarze 220x230mm kompatybilną z koszę 243x240x70mm?

Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie poz.33 w celu zwiększenia konkurencyjności ofert?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maty o wyżej podanym wymiarze oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**Pakiet nr 79 Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne.**

**33.** Lp.1 Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 400 g lub 500 g.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**34.** Lp.4 Prosimy o dopuszczenie kulociągu Schroeder lub Braun.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**35.** Lp.16 Prosimy o dopuszczenie pęset o dł. 150 lub 160 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaoferowania peset prostych czy zagiętych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**36.** Lp.18 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dl. 190 mm, lub kleszczyków Overholt-slim o dł. 185 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**37.** Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 250 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**38.** Lp.32i 33 Prosimy o możliwość zaoferowania kosza oraz pokrywy jako kompletu w jednej pozycji. Prosimy o dopuszczenie kosza z jednego kawałka blachy o wym. perforacji dna, ścian bocznych oraz pokrywy 2 mm, o wym. 250x259x64 mm razem z pokrywą.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**39.** Lp.34 Prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o wym. 260x250 mm lub 460x240 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maty o wyżej podanych rozmiarach. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**40.** Lp.35 Prosimy o odpuszczenie kleszczyków o dł. 125 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**41.** Lp.39 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Fox, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**42.** Lp.41 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Meztzenabum, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**Pakiet nr 80 Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne, szydełko do flebectomii i piłki Gigliego.**

**43.** Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Lister o dł. 240 mm, z jednym uchem krótszym, drugim dłuższym.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**44.** Lp.4 Prosimy o odpuszczenie piłki o śr. 1 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**45.** Lp.5 Prosimy o odpuszczenie piłki o śr. 1 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.**

**46.** Lp.6 Prosimy o odpuszczenie piłki o śr. 1 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**47.** Lp.7 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Ochsner (typ Kocher), pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**48.** Lp.8 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Ochsner (typ Kocher), pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**49.** Lp.9 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Ochsner (typ Kocher-Ochsner), pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**50.** Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Ochsner (typ Kocher-Ochsner), pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**51.** Lp.11 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Ochsner (typ Kocher-Ochsner), pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**Pakiet nr 82 Podważki biodrowe i rączka typu Steinmana.**

**52.** Lp.1 Prosimy o dopuszczenie podważki Lange-Hohmann, nieżłobionej o szer. 30mm i dł. 270 mm lub podważki Hohman, złobionej o wymaganych parametrach lub podważki Lange złobionej o szer. 22 mm i dł. 220 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**53.** Lp.4 Prosimy o odpuszczenie podważki o dł. 260 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**54.** Lp.5 Prosimy o odpuszczenie podważki o dł. 260 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**55.** Lp.6 Prosimy o dopuszczenie podważki o szer. 34 mm i dł. 285 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**56.** Lp.7 Prosimy o dopuszczenie podważki o dł. 390 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**57.** Lp.8 Prosimy o dopuszczenie podważki o szer. 34 mm i dł. 390 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**58.** Lp.9 Prosimy o dopuszczenie podważki bez nazwy własnej typu Cobra o wym części roboczej 26x80 mm i dł. 350 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**59.** Lp.10 Prosimy o dopuszczenie rączki bez nazwy własnej.

**Odpowiedź: NNie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem.**

**60.** Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla Pakietów 79,80,82 od 45 do 72 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w

życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu w Pakiecie nr 79, 80, 82.**

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące terminu dostawy opisanego w części IV pkt 2 SIWZ:

1. w ppkt b) wykreśla się 79, 80.

2. dodaje się ppkt e) o treści: **45 – 72 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 79, 80, 82)**

**Część IV pkt 2 SIWZ przyjmuje brzmienie:**

2. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:
   - **a) 3 - 7 dni od złożenia zamówienia;**
   - **b) 21 – 56 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 78, 81, 86, 92, 96);**
   - **c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 91, 95, 98);**
   - **d) 24 – 48h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 97),**
   - **e) 45 – 72 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 79, 80, 82)**

   Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym termin.

3. Powyższe zapisy modyfikuje się również we wzorze umowy w załączniku nr 6 w §3 ust 2 oraz w załączniku nr 1 – formularzu oferty w pkt I pod tabelą.

**61.** Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 pakiet 7 dopuści postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach:

dla pozycji 1 – 15 cm

dla pozycji 2 – 20 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J" z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o wyżej opisanej charakterystyce.**

**62. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 60**

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu. dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.**

**63. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 60**

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem" (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie każdego wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu.**

**64. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 60**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego kompatybilnego z urządzeniem którym dysponuje Zamawiający, tj. strzykawka automatyczna CT Motion.**

**65. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 60**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie każdego wężyka, który może być zainstalowany w strzykawce przez 24h i więcej, jeżeli spełnia wszystkie wymogi wyrobu medycznego.**

**66. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 60**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150 cm wynosiła dokładnie 7,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wężyków odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ.**

**67. Dotyczy: SIWZ, V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, 3) f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna zapis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

**68. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa dostawy – wzór, § 3 ust. 2 a)**

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostawy na 3-7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy na dni robocze.**

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące terminu dostawy opisanego w części IV pkt 2 SIWZ:

**I. Część IV pkt 2 ppkt a) SIWZ przyjmuje brzmienie:**

„2. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:

**a) 3 - 7 dni roboczych od złożenia zamówienia;**

**b) 21 – 56 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 78, 81, 86, 92, 96);**

**c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 91, 95, 98);**

**d) 24 – 48h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 97),**

**e) 45 – 72 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 79, 80, 82)**

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym termin."

II. **załącznik nr 6 do SIWZ §3 ust. 2 ppkt a) wzoru umowy przyjmuje brzmienie:**

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:

**a) ..... dni roboczych od złożenia zamówienia**

III. Powyższe zapisy modyfikuje się również w załączniku nr 1 – formularzu oferty w pkt I pod tabelą.

**69. DOTYCZY PAKIETU NR 79 POZ.30 – Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.**

**70. DOTYCZY PAKIETU NR 79 POZ.32 – Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne**

Czy zamawiający dopuści kosz perforowany ze stali nierdzewnej o wymiarach 410x240x70mm, pozostałe parametry bez zmian? Jeśli nie, prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego kosza i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**71. DOTYCZY PAKIETU NR 79 POZ.33 – Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne**

Czy zamawiający dopuści przykrycie do kosza o wymiarze 411x243 mm kompatybilne z koszem 410x240x70mm, pozostałe parametry bez zmian? Jeśli nie prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego kosza i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**72. DOTYCZY PAKIETU NR 79 POZ.34 – Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne**

Czy zamawiający dopuści mate silikonową o wymiarach 380x230mm kompatybilną z koszem 410x240x70mm? Jeśli nie prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanej maty i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

73. DOTYCZY PAKIETU NR 80 POZ.5 – Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne - szydełko do flebectomii i piłki Gigli.

Czy zamawiający dopuści piłki Olivecrona, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego narzędzia. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.**

**74. Pakiet 78, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową, owalną; wymiary 2,5x06x13mm, wtyk 4mm, dł. 62mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej elektrody.**

**75. Pakiet 78, poz. 21**

76.Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z kablem 4,5m z wtykiem do diatermii ERBE ICC przeznaczony do min. 75 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego uchwytu.**

**77. Pakiet 12 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zacisk rolkowy zamiast przesuwnego?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.**

**78. Pakiet 12 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści skalę z podziałką ml z regulacją przepływu 5-250ml w kształcie cylindra?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**79. Pakiet 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.**

**80. Pakiet 18 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności w zakresie 6-10 ml?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.**

**81. Pakiet 18 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PVC, biokompatybilna, nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej maski krtaniowej.**

**82. Pakiet 18 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści długość 1,8 m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**83. Pakiet 18 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści długość do rurek intubacyjnych 60cm, natomiast do rurek tracheostomijnych 30cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek o długości 60cm.**

**84. Pakiet 18 poz. 13**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.**

**85. Pakiet 18 poz. 15**

Czy w związku z tym, że Zamawiający oczekuje szczoteczki z wbudowaną funkcją odsysania, Zamawiający będzie wymagał szczoteczek klasy IIa, których można używać razem ze ssakiem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek z wbudowaną funkcją odsysania, klasy IIa, których można używać razem z ssakiem.**

**86. Pakiet 18 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści odsysanie od góry i od boku?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**87. Pakiet 18 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści plastikową główkę z gąbką poliuretanową po przeciwnej stronie szczoteczki?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**88. Pakiet 18 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści odsysanie od góry i od boku?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**89. Pakiet 18 poz. 16**

Czy w związku z tym, że Zamawiający oczekuje szczoteczki z wbudowaną funkcją odsysania, Zamawiający będzie wymagał szczoteczek klasy IIa, których można używać razem ze ssakiem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek z wbudowaną funkcją odsysania, klasy IIa, których można używać razem z ssakiem.**

**90. Pakiet 19 poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje myjki nawilżonej czy też myjki suchej?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje myjki nawilżonej.**

**91. Pakiet 19 poz. 3**

Czy w przypadku oczekiwania przez Zamawiającego myjki suchej dopuści rozmiar 30x33cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**92. Pakiet 19 poz. 3**

Czy w przypadku oczekiwania przez Zamawiającego myjki nawilżonej dopuści rozmiar ok. 20x20cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjki nawilżonej w rozm. 20x20cm.**

**93. Pakiet 19 poz. 3**

Czy w przypadku oczekiwania przez Zamawiającego myjki suchej z mydłem aktywowanym pod wpływem wody dopuści rozmiar 12x20cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**94. Pakiet 51 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny – przezroczystą?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie torby przezroczystej.**

**95.** Pakiet 49,poz. 1-15;20-23,29-30

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-15;20-23,29-30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.**

**96. Pakiet 51**

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków o wyżej opisanych parametrach.**

**97. Pakiet 83**

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski zaciskowej na udo o rozmiarach 85x14cm zamiast 85x16cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opaski opisanej powyżej.**

**Zapytania dot. zapisów wzoru umowy: Załącznik 6**

**98. Czy Zamawiający w §4 ust. 4 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?**

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru umowy w podanym paragrafie. SIWZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.**

**99. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:**

**1.lit a z 1% wartości zamówionego towaru na 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru,**

**2.lit b zmiana na: „Z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości pakietu nie więcej niż 2000zł"?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy stwierdzić, że kwotowe naliczanie kar umownych może doprowadzić do sytuacji, iż kara umowna może przekroczyć wartość zamówienia częściowego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać,

za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. $353^1$k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy". Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. SIWZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.**

**100. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Informujemy, że zapis jest już umieszczony w podanym paragrafie wzory umowy.**

**101.** Pakiet nr 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na grotowkręty Schanza fi 3,0mm L=150mm zamiast fi 3,5mm L=150mm?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwoździe Steinmanna zamiast grotowkrętów Steinmanna?

LUB

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na grotowkręty Steinmanna z gwintem centralnym fi 6,5mm L=150mm, 200mm, 280mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wszystkich wyżej opisanych gwoździ i grotowkrętów.**

**102.** Pakiet nr 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 4, 9, 12, 18, 19, 24-39?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pakiet nr 98**

**103.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytkę bez multikątów?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**104.** Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na płytkę 3-5 otworów w trzonie i 5-7 otworów w nasadzie, L=59-75mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**105.** Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę płyty o długościach i grubościach:

L=50-146mm gr. 2,2mm

L=69-147mm gr. 2,6mm

L=60-144mm, gr. 3,0mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**106.** Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na wkręty o dł. od 10-60mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**107.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie lub wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 7, 21-31?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**108.** Czy Zamawiający w pozycji nr 10 wyrazi zgodę na płytkę o dł. 58-124mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**109.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 16-20?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pakiet nr 9, pozycja 16-20**

**110.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę gwoździa śródszpikowego krętarzowego

Z opisu:

Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy **8 mm** i długościach od **70mm do 135mm**. Zaślepka w długości **18mm**.Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach **32mm i 47mm**. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co **5mm**. Średnice gwoździa 11 mm i 13mm , długość **225 mm**. W kątach CCD: 130°, 135°. **Gwóźdź z celownikiem zewnętrznym, przeziernym.**

Na opis:

Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicach **6,5mm oraz 11mm** i długościach od **70mm do 120mm**. Zaślepka w długościach **13mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm**. Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długości **31mm**. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co **2mm**. Średnice gwoździa 11 mm i 13mm , długość **220 mm**. W kątach CCD: 130°, 135°. **Gwóźdź niekompletnie pokryty celownikiem, prowadnica obejmuje jedynie otwory bliższe, dalszych nie. Gwóźdź z celownikiem nieprzeziernym.**

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**111.** Czy Zamawiający wyrazi zgodnę na zamianę wkrętów doszyjkowych, samogwintujących **Ø 8mm**, długość od 70 mm - **135mm** ze skokiem co 5 mm na wkręty doszyjkowe samogwintujące **Ø 6,5mm oraz Ø 11mm** , długość od 70 mm - **120mm** ze skokiem co 5 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**112.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wkręta zaślepiającego o długości **18 mm** na wkręt zaślepiający o długościach **13mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm**

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**113.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wkręta nastawczego o długościach **32 mm i 47 mm** na wkręt nastawczy o długości **31mm** ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**114.** *pakiet nr 93 System do rekonstrukcji ACL i kotwiczki do barku*

Czy Zamawiający dopuści do zestawu implantów (zamiennie), implanty równoważne do opisanych w SIWZ:

**Dla pkt.1**

**Część piszczelowa** – Zamiennie dla śrub intereferencyjnych wykonanych z PLDL, Implant biowchłanialny w postaci biowchłanialnej śruby interferencyjnej zbudowanej z ko-polimeru PLGA (Poli-L-Laktyd-Co-Glikolidowy) w rozmiarach śr. 7mm i dł. 30mm i śr. 8-10mm i dł. 30mm

Pozostałem parametry dotyczące implantu w części udowej typu endobutton zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zapewni instrumentarium zgodnie z SIWZ do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ww. implantów.

**Dla pkt.2**

Zamiennie kotwica wykonana z PEEK o średnicy Ø 5 mm, dł. 15 mm. Kotwica zaopatrzona w 2x nić pleciona odporna na rozrywanie wykonana z poliethylenu 0.6 Ø x 800 w dwóch kolorach (1 biała + 1 niebieska) Nici z Igłami zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej śrubokręta (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania kotwicy w tkanki). Stożkowa budowa z dużą amplitudą gwintowania: progresywne wprowadzanie implantu z zachowaniem tkanki kostnej Jednorazowy aplikator zaprojektowany tak aby pewnie i szybko wprowadzać kotwicę w tkanki.

Wykonawca zapewni instrumentarium zgodnie z SIWZ do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ww. implantów

**Dla Pkt.3:**

Zamiennie kotwica wykonana z PEEK o średnicy Ø 6.5 mm, dł. 17 mm. Kotwica zaopatrzona w 2x nić pleciona odporna na rozrywanie wykonana z poliethylenu 0.6 Ø x 800 w dwóch kolorach (1 biała + 1 niebieska) Nici z Igłami zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej śrubokręta (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania kotwicy w tkanki). Stożkowa budowa z dużą amplitudą gwintowania: progresywne wprowadzanie implantu z zachowaniem tkanki kostnej Jednorazowy aplikator zaprojektowany tak aby pewnie i szybko wprowadzać kotwicę w tkanki.

Wykonawca zapewni instrumentarium zgodnie z SIWZ do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ww. implantów

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych, równoważnych implantów.**

**115. Dotyczy pak. 39**

Czy Zamawiający w tym zadaniu wymaga użyczenia klipsownicy do klipsów tytanowych z branszami prostymi czy też z branszami zagiętymi pod kątem 25 stopni co polepsza manewrowanie klipsownicą z zaaplikowanym klipsem (lepsza widoczność podczas zakładania klipsa). A dla potwierdzenia oferent zobowiązany jest dołączyć folder klipsownicy.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga użyczenia klipsownicy do klipsów tytanowych z branszami zagiętymi pod kątem 25 stopni.**

**116. Dotyczy pak. 39 poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych naczyniowych niewchłanialnych (II Generacji) z serią zębów w kształcie stożka .Kąt podcięcia zamykanej struktury tkankowej 45 stopni. Stabilność poprzeczka klipsa na poziomie 15 N.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych naczyniowych niewchłanialnych (II Generacji) z serią zębów w kształcie stożka. Kąt podcięcia zamykanej struktury tkankowej 45 stopni. Stabilność poprzeczka klipsa na poziomie 15 N.**

**117. Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym

przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."
**Odpowiedź: Tak, zgodnie z odp nr 67.**

**118. Pakiet nr 59 poz.1**
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podajników na 3 kartoniki?
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podajników na 3 kartoniki.**

**119. Pakiet nr 59 poz.2**
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy nitrylowej diagnostycznej o sile zrywu po starzeniu min.9.20N, pozostałe parametry zgodne?
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic nitrylowych diagnostycznych o sile zrywu po starzeniu min.9.20N.**

**Pytania do wzoru umowy**

**120.** Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.**

**121.** Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta." UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym

momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. Zamówienia są składane wg bieżących potrzeb. SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.**

**122.** Wnosimy o modyfikację §4 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych."
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy o powyższy zapis.**

**123.** Wnosimy o wykreślenie § 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej."
**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla treść § 5 umowy i tym samym zmienia nr pozostałych paragrafów, aby była w kolejności. Zmiana w załącznikach nr 6 i 6.1.**

**124.** Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 lit. projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:
1. 0,5% wartość zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);
2. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b);

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny") oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP") poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.**

**125.** Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w:

Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.**

**126.** Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.**

**127.** Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy)."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wadium. SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.**

**128.** Zwracamy się z prośba w zad. 3, o możliwość złożenia oferty na cewnik Foley, 14CH-22CH, wykonany z 100% silikonu z możliwością utrzymywania do 12 tyg.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników Foley, 14CH-22CH, wykonanych ze 100% silikonu z możliwością utrzymywania do 12 tyg.**

**129.** Czy Zamawiający w zad. 39, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: **Klipsy do laparoskopii - do klipsownicy HEMOCLIP PLUS, tytanowe,w zasobniku po 6 szt., magazynki z samoprzylepną taśmą?**
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**130.** Czy Zamawiający w zad. 39, poz.3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: **Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki zintegrowane, ząbki wewnątrz klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące, eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask – eliminujący nożycowanie. Magazynki zawierające 6 klipsów, posiadające taśmę mocującą, dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy, zawierające LoT, REF. 1 opakowanie = 14 magazynków w których jest 6 klipsów?**
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**131.** Czy zgodnie z przepisami unijnymi, w zad. 39, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie klipsownic rozbieralnych do wymienionych pozycji?
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**132.** W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad. 39 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**133.** Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 39 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie

wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**134.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 71: taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość max. 1870 µm, gramatura 48 g/m$^2$, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej taśmy.**

**135. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 77, poz. nr 1:**

system - siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m$^2$, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, szerokość 5 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonany w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca), końce zakończone bezpiecznymi pętelkami **oraz** 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w systemu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania siatki zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**136. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 77, poz. 2:**

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość max. 1870 µm, gramatura 48 g/m$^2$, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężane końce?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania taśm zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**137. Dotyczy Pakietu nr 77, poz. 2:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**138.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnch do w/w pakietów w razie wezwania celem weryfikacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbek niesterylnych.**

**139. Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z odp nr 67.**

**140. Pakiet 34 pozycja 14**

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu 34, pozycji 18, producent wycofał ten opatrunek, a nie wydzielenie tego produktu uniemożliwi przystąpienie i złożenie ofert na cały pakiet.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji o wycofaniu opatrunku i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.**

**141.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 89 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania Grotowkręt Schanza Ø 3,0mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Grotowkrętu Schanza Ø 3,0mm.**

**142.** Czy Zamawiający w **pakiecie 91 poz. 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20** zamawiający dopuści płytki z otworami, dwufunkcyjnymi kompresyjno – blokowanymi?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**143.** Czy Zamawiający w **pakiecie 91 poz. 35** zamawiający dopuści śruby blokujące trzonowe do gwoździ anatomicznych z mocowaniem typu sześciokąt?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**144.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu wiertarskiego z akcesoriami w ramach pakietu 91?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi os wymogu użyczenia napędu.**

**145.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia rozwiertaków śródszpikowych w ramach pakietu 91?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu użyczenia rozwiertaków.**

**146.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności w ramach pakietu 91?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu sterylności.**

**147.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści igły 0,45x16?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o podanym rozmiarze.**

**148.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści igły 0,45x22?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o podanym rozmiarze.**

**149.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści igły 0,45x25?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o podanym rozmiarze.**

**150.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 11 dopuści wycenę za op. a'100sztuk.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę pozycji za opakowanie 100 sztuk.**

**151.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu niebędącego wyrobem medycznym, na 23% stawce vat?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu niebędącego wyrobem medycznym.**

**152. Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu o dł. 50cm.**

**153. Pakiet 4, pozycja** 2

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego drenu.**

**154. Pakiet 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 700mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu Redon z trokarem o dł. 700mm.**

**155. Pakiet 4, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny pakowane a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaciskaczy pakowanych po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**156. Pakiet 4, pozycje 36,37,38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**157. Pakiet 4, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 16-24? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zgłębników w podanym wyżej rozmiarze.**

**158. Pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z krzyżową perforacją na długości 14cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie nie dopuszcza zaoferowania drenu o wyżej podanej długości.**

**159. Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,45 x 16mm lub 0,45 x 22mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm.**

**160. Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości igły +/- 3mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję długości igły +/- 3mm.**

**161. Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igły Pencil-Point w rozmiarze 25G x 120mm lub 27G x 120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły w rozmiarze 25G x 120mm.**

**162. Pakiet 11, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki 20ml w opak. 50 szt z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganę4j w SIWZ.**

**163. Pakiet 12, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z regulacją zależną od drenu, zaciskiem rolkowym dla krótkich przerw infuzji, z regulacją przepływu 5-250ml/h w kształcie walca?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowanie przyrządu zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**164. Pakiet 14, pozycje 1-6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤10µg/g?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.**

**165. Pakiet 14, pozycje 13-18**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤79µg/g oraz sile zrywu przed starzeniem 9N?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.**

**166. Pakiet 14, pozycje 19-24**

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice ortopedyczne były odporne na przenikanie metakrylanu metylu (cementu kostnego)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby rękawice ortopedyczne były odporne na przenikanie cementu kostnego.**

**167. Pakiet 19, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta, bez lateksu, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20sek. w 800W)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego czepka.**

**168. Pakiet 19, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta w opakowaniach a'12 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjek w opakowaniu 12 szt.**

**169. Pakiet 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 33cm x 22cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ścierek w podanym rozmiarze.**

**170. Pakiet 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za ściereczki pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ścierek pakowanych po 10 szt.**

**171. Pakiet 21, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**172. Pakiet 25, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**173. Pakiet 25, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**174. Pakiet 25, pozycja 22-23**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**175. Pakiet 26, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a'12 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra pakowanego po 12 szt.**

**176. Pakiet 26, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy pakowany a'24 sztuki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra pakowanego po 24 szt.**

**177. Pakiet 26, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy pakowany a'12 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra pakowanego po 12 szt.**

**178. Pakiet 26, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm pakowany a'3 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici w rozmiarze 6x75mm pakowany a'3 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ.**

**179. Pakiet 26, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści plaster z wkładem chłonnym z wiskozy i poliestru?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plaster z wkładem chłonnym z wiskozy i poliestru.**

**180. Pakiet 26, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'30 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra pakowanego po 30 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**181. Pakiet 26, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, przezroczysty w całości wykonany z folii poliuretanowej, posiadający system aplikacji typu „ramka" oraz metkę do opisu, pakowany a'100 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego opatrunku, pakowanego po 10 szt z odpowiednim przeliczeniem do ilości podanej w SIWZ.**

**182. Pakiet 26, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**183. Pakiet 27, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

**Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**184. Pakiet 27, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 8cm x 34cm pakowanie a'20 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu ginekologicznego w rozmiarze 8cm x 34cm pakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**185. Pakiet 27, pozycja 9-10**

Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniach a'100 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tupfery w opakowaniach a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**186. Pakiet 28, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze powierzchni całkowitej 70 x 80 cm, powierzchnia lepna 74 x 70 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii w wyżej podanym rozmiarze.**

**187. Pakiet 28, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze powierzchni całkowitej 45 x 55 cm, powierzchnia lepna 45 x 49 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii w wyżej podanym rozmiarze.**

**188. Pakiet 28, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze powierzchni całkowitej 42 x 42 cm, powierzchnia lepna 42 x 36 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania folii w wyżej podanym rozmiarze.**

**189. Pakiet 29, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z folii poliuretanowej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii chirurgicznej wykonanej z folii poliuretanowej.**

**190. Pakiet 29, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45 x 55 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii w podanym rozmiarze.**

**191. Pakiet 29, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 56 x 84 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii w podanym rozmiarze.**

**192. Pakiet 40, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego systemu.**

**193. Pakiet 40, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych worków.**

**194. Pakiet 49, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków pakowanych po 90 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**195. Pakiet 49, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści pas do KTG szary, posiadający odstępy pomiędzy otworami - 3cm?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasa posiadającego odstępy pomiędzy otworami 3 cm.**

**196.** Czy Zamawiający dopuści etykiety w rozmiarze 35 x 25 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiety w rozmiarze 35x25mm.**

**197. Pakiet 49, pozycja 32-33**

Czy Zamawiający dopuści kołnierz stabilizujący z otworem tracheotomijnym wykonany z wyprofilowanej anatomicznie pianki polietylenowej, wzmocnienia z PCV, przepuszczalny dla promieni RTG, zapinany i regulowany przy pomocy taśmy zapinanej na rzep w rozmiarach S (obwód szyi 26-33 cm), M (obwód szyi 33-40 cm] ,L obwód szyi 40-48 cm]?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaoferowanie wyżej opisanego kołnierza.**

**198. Pakiet 49, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści marker z fioletowym tuszem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie markera z fioletowym tuszem.**

**199. Pakiet 51, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie torby o pojemności 2000ml.**

**200. Pakiet 52, pozycje 1 - 2**

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem o szerokości ok 3,5cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie golarek o szerokości ok. 3,5cm pod warunkiem, że poz. 2 będzie wyrobem medycznym.**

**201. Pakiet 54, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x30 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**202. Pakiet 54, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści papier do drukarki Sony na rolce o długości 25m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru w rolce o dl. 25m.**

**203. Pakiet 54, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**204. Pakiet 54, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x140x150 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**205. Pakiet 54, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 28x25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**206. Pakiet 55, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach 90x45x39, pakowane w opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych szczotek z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**207. Pakiet 65, pozycja** 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe miarki pakowane a'1000 sztuk z przeliczeniem opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miarek pakowanych po 1000 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ.**

**208.** Czy termin dostawy liczony jest w dniach roboczych? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na dni robocze?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 68.**

**209.** Pakiet 20 poz. 1-3: czy Zamawiający wymaga siatek o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych siatek.**

**210.** Pakiet 20 poz. 4, 5, 7, 8: czy Zamawiający wymaga aby wyroby te były sklasyfikowane w klasie II regule 7?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane wyroby były sklasyfikowane w klasie II regule 7.**

**211.** Pakiet 20 poz. 4, 5, 7, 8: czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyżej opisanego raportu walidacji.**

**212.** Pakiet 20 poz. 6: czy Zamawiający wymaga gazy w metrach bieżących o szerokości 0,9 m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie gazy w metrach bieżących o szerokości 0,9 m.**

**213.** Pakiet 20 poz. 7, 8: czy Zamawiający wymaga, aby kompresy jałowe, miały minimalną gramaturę:

- 10 x 10 cm - 2,11 g
- 7,5 x 7,5 cm - 1,24 g?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie kompresów o podanej gramaturze.**

**214.** Pakiet 25 poz. 24: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie waty w opakowaniu 500g z odpowiednim przeliczeniem ilości do wymaganej w SIWZ z podaniem wartości do dwóch miej po przecinku.**

**215.** Pakiet 25 poz. 24-25: czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe jak w przypadku waty bawełniano-wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi

działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej waty bawełnianej.**

**216.** Pakiet 25 poz. 25: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty 100% bawełnianej?

**Odpowiedź: Tak.**

**217.** Pakiet 25 poz. 26: czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią.**

**218.** Pakiet 29 poz.1-3: czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne wykonane z cienkiej folii polieretanowej, rozciągliwe i elastyczne, przepuszczające parę wodną, nie podrażniające skóry, nie wywołujące reakcji alergicznych, nie zawierające lateksu oraz niecytotoksyczne?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**219.** Pakiet 29 poz.2: czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne w rozmiarze 45x55 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii o podanych rozmiarze.**

**220.** Pakiet 29 poz.3: czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne w rozmiarze 90x60 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania folii o podanych rozmiarze.**

**221.** Pakiet 71: czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,16 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 (+/-0,2) cm, grubość ok. 0,54 mm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej taśmy.**

**222.** Pakiet 71: czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym i niebieskim, o grubości nici 0,08 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 30 cm, szerokość 1,1 (+/-0,1) cm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej taśmy.**

**Dot. wzoru umowy**

**223.** Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z § 6 ust. 1 a) wzoru umowy do 0,5% lub inne złagodzenie kary umownej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.**

**224.** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów § 6 ust. 1 b) wzoru umowy na: "z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości niezrealizowanej części Pakietu."?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapizów wzoru umowy.**

**Pakiet nr 74 Stapler liniowy i akcesoria**

**225. Poz. 1**

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 1 dopuści uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy liniowy z nożem do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, trzon o długości 16 cm z możliwością rotacji o 360°, długość linii szycia 60mm. Nowy nóż w każdym ładunku?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**226. Poz. 2**

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 2 dopuści uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy liniowy z nożem do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, trzon o długości 26 cm z możliwością rotacji o 360°, długość linii szycia 60 mm. Nowy nóż w każdym ładunku?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**227. Poz. 3**

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 3 dopuści ładunek jednorazowego użytku do liniowego endoskopowego staplera tnącego do resekcji, przecinania i zespoleń, z tytanowymi zszywkami, ładunek prosty, o długości 60 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i

jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm (złoty)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**228. Poz. 4**

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wys. zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub grubej wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**229. Poz. 5**

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 5 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**230. Poz. 6**

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 6 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

231. Poz. 7

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 7 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

232. Poz. 9

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 9 dopuści długość linii szwu 42,5 mm dla rozmiaru 45, długość linii szwu 59 mm dla rozmiaru 60, długość linii szwu 92 mm dla rozmiaru 90 pozostałe parametry wg SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

233. Poz. 10

Czy Zamawiający w pak. 74 poz. 10 dopuści długość linii szwu 42,5 mm dla rozmiaru 45, długość linii szwu 59 mm dla rozmiaru 60, długość linii szwu 92 mm dla rozmiaru 90 pozostałe parametry wg SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**Pakiet nr 89**

234. POZ. I 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego grotowkrętu.**

235. POZ. I 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 6,0 mm L - 180 mm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego grotowkrętu.**

236. POZ. IV 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 150

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego grotowkrętu.**

237. POZ. IV 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 175

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego grotowkrętu.**

238. POZ. IV 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 225

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego grotowkrętu.**

**239. dotyczy pakietu 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, zwrot wilgoci 32,3mg H2O/L, minimalna objętość oddechowa >180ml, z portem do kapnografu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego filtra.**

**240. dotyczy pakietu 18 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga urządzenia nadkrtaniowego o nazwie I-Gel?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga urządzenia nadkrtaniowego o nazwie I-Gel.**

**241. dotyczy pakietu 18 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną maskę krtaniową w rozmiarach 1-5, wykonaną z PCV z mankietem z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopiony w korpus rurki z informacją o rozmiarze na baloniku kontrolnym, z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej maski.**

**242. dotyczy pakietu 18 poz.13**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową wyposażoną w mechanizm antyokluzyjny, z wbudowanym obrotowym łącznikiem tlenowym i zatrzaskową klapką umożliwiającą wprowadzenie cewnika, z minimalną objętość oddechową >60ml, wagą 8g, przestrzenią martwą 19ml, zwrot wilgoci 26 mg H2O/L przy VT 500ml, sterylny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego wymiennika.**

**243. dotyczy pakietu 18 poz.13**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy, nawilżenie 26,1 mg H2O/L przy VT 500ml, przestrzeń martwa 19ml, waga 9g, minimalna objętość oddechowa >60ml, z zatrzaskową klapką umożliwiającą wprowadzenie cewnika, sterylny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego wymiennika.**

**244. dotyczy pakietu 18 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji mikrobiologicznie czysty, skład: nebulizator, łącznik T, ustnik, dren 1,8 m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.**

**245. dotyczy pakietu 66 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga łyżki światłowodowej jednorazowego użytku, wykonanej ze sztywnego plastiku ABS, matowej w kolorze szarym, nieprzezroczystej, z możliwością stosowania w MRI, kompatybilnej z uchwytami ISO7376/3- zielony standard, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru łyżki, pakowanej pojedynczo w folię-papier, mikrobiologicznie czystą w rozmiarach 1-4?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania łyżki światłowodowej o wyżej opisanych parametrach.**

**246. dotyczy Pakietu nr 97 poz. 3,4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 97 w poz. 3 i 4 a-i wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.**

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy §1 ust 4 dodając powyższą treść. Paragraf otrzymuje brzmienie: „Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do użyczenia bez odrębnego wynagrodzenia Zamawiającemu na czas trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do zakładania protez w tym wiertarkę elektryczną zasilaną akumulatorowo, piłę zasilaną akumulatorowo (w pakiecie startowym z min 1 ostrzem) wraz z kompletem podwójnych baterii i ładowarką stacjonarną. Zestaw haków niezbędnych do wykonania zabiegu. Podwójny pakiet wszystkim rozmiarów implantów. W przypadku odesłania faksem protokołu zużycia Wykonawca w czasie niezwłocznym **nie dłużej niż ..... godzin dostarczy na swój koszt zużyty implant.** Narzędzia należące do Wykonawcy będą wymienione z chwilą ich mechanicznego uszkodzenia lub stępienia (dotyczy głownie frezów panewkowych) po poinformowaniu przez Zamawiającego **LUB Wykonawcza zobowiązany jest dostarczyć implanty wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym".**

**247. dotyczy projektu umowy**

Czy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej ( zapis w formacie PDF ). W celu zabezpieczenia autentycznosci faktury i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w wyżej opisanej formie.**

**248. pakiet 78, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych dł. 4,5m, wtyczka ze strony instrumentu o średnicy 4mm, od strony aparatu średnica 4mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego kabla monopolarnego.**

**249.** Czy w pakiecie nr 46 Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. nr 2 z zestawienia (przewidywana dyskontynuacja produkcji asortymentu)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia pozycji do osobnego Pakietu. W przypadku podanym wyżej należy podać ostatnią obowiązującą cenę produktu wraz z zamieszczeniem informacji o zakończeniu produkcji, dyskontynuacją produkcji itp.**

**250.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie „młotka 22cm/400g" pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**251.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie „kleszczyków TYP Allis 20 cm, 5x6 ząbków" pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**252.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Pean hemostatyczny typu Overholt 18,5cm" pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**253.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Pean do gazików prosty 27cm równoważny" pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**254.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Kosz perforowany ze stali nierdzewnej 400x245x50mm, składane uchwyty, perforowane dno 4x4mm, perforowane ścianki 2x2mm, polerowany elektrolitycznie" Pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**255.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Kosz perforowany ze stali nierdzewnej 400x245x70mm, składane uchwyty, perforowane dno 4x4mm, perforowane ścianki 2x2mm, polerowany elektrolitycznie" Pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**256.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 33 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Pokrywy do kosza ze stali nierdzewnej 400x245 perforacja 4x4mm" pozostałe parametry bez zmian?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**257.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Maty sylikonowej do kosza 400x245" pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**258.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 79 poz. 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Nożyczek ALLAINE tępych, końcówki zagięte 18cm", które są odpowiednikiem nożyczek Metzenbaum-Nelson, pozostałe parametry bez zmian? Różnica wynika tylko z odmiennego nazewnictwa różnych producentów tego samego typu artykułu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**259.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 80 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Nożyczek opatrunkowych dł. 18 cm, typu Cast Catter uchwyt ergonomiczny jedno ucho w uchwycie krótsze?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego narzędzia. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**Pakiet 77 – Siatki z polipropylenu monofilamentowego, taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu.**

**260.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 77:

**poz. 1** system/siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilametowego, o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, każde zakończone kolorowymi pętelkami; wysokość siatki 9,1 cm, szerokość 4-6 cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², zestaw bez nitinolowych prowadnic, do implantacji narzędzia wielokrotnego użytku, przekazane nieodpłatnie przy pierwszym zamówieniu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych siatek. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**261. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 77:**

**poz. 2** taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, tkana metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, długość 45 cm, szer. 1,1 cm, zwężenia na końcach, taśma zaopatrzona z dwóch stron w długie pętelki?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych siatek. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**Pakiet 76 – Trokary.**

**262.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 76:

**poz. 1** trokar laparoskopowy jednorazowy, 5 mm. Osłona ostrza. Podwyższone bezpieczeństwo otwarcia powłok, bez dodatkowych kaniuli/obturatora.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych trokarów. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**263.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 76:

**poz. 2** trokar laparoskopowy jednorazowy, 5-12 mm. Osłona ostrza. Podwyższone bezpieczeństwo otwarcia powłok, bez dodatkowych kaniuli/obturatora.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych trokarów. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**Pakiet nr 40 Zestawy do zbiórki stolca**

**264. Pozycja nr 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: *System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu iry-gacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszcze-nia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połą-czone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera latek-su, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni.*

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego produktu.**

**265. Pozycja nr 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: *Worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego - kompatybilne z powyższym zestawem. Skala zaczyna się od 100 ml, następnie skalowane co 250 ml.*

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego produktu.**

**Pakiet nr 18 układy oddechowe**

**266. Pozycja nr 2** Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 2.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**267. Pozycja nr 5** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie metalowych łyżek laryngoskopowych jednorazowego użytku do pozycji nr 5.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania metalowych łyżek laryngoskopowych.**

**268. Pozycja nr 11** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o długości 56 cm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu o dł. 56 cm.**


**269.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 1** młotek o wadze 400 g?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**270.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 19** pean hemostatyczny typu Rumel o długości 24 cm?


**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego narzędzia.**

**271.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 30** kleszcze diagnostyczna o długości 33 cm, średnicy 5,0 mm?

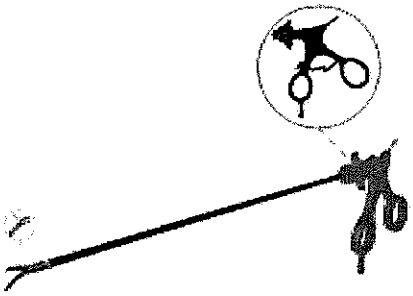


**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego narzędzia.**

**272.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 32 kosz perforowany o wymiarach 255x245x70 mm?

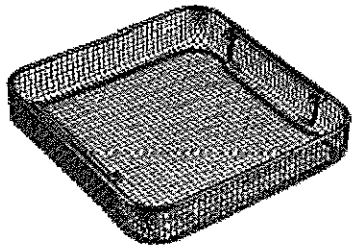


**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**273.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 33** przykrycie do kosza o wymiarach 255x245 mm?

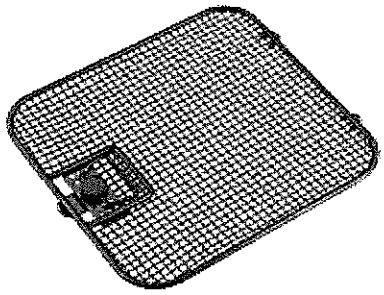

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**274.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 34** matę silikonową o wymiarach 245x245 mm?

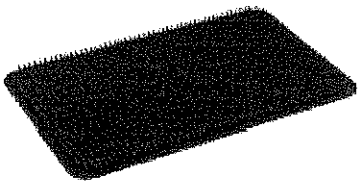

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**275.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 37 pincetę anatomiczną Adson mikro 0,8 mm o długości 12 cm?



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego narzędzia.**

**276.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 38** pincetę anatomiczną Adson 1,2 mm o długości 12 cm?



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego narzędzia.**

**277.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 79 poz. 40** pincetę chirurgiczną Adson ½ ząbka, 1,2 mm o długości 12 cm?




**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego narzędzia.**

**278.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 41 nożyczki Metzenbaum, tępe, zagięte o długości 18 cm?




**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**279.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 80 poz. 3** nożyczki opatrunkowe o długości 20 cm, TC, pozostałe bez zmian?

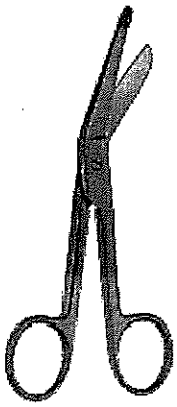

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**280.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 80 poz. 4 oraz 6** piłki Gigli o średnicy 1,5 mm, długości 40 cm oraz 50 cm?

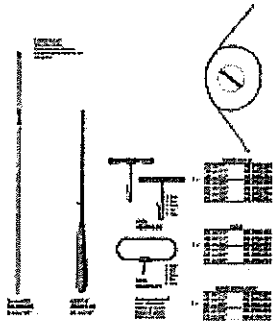

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

**281.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 80 poz. 5** piłki Gigli o średnicy 1,5 mm, długości 50 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1846 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

**1. Część IX SIWZ: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

W ofercie jest:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **25.03.2021r do godz. 10:00.**

W ofercie powinno być:

**Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 30.03.2021r do godz. 10:00.**

**2. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 SIWZ:**

W ofercie jest:

Składanie ofert **do dnia 25.03.2021r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.03.2021r. o godzinie 12:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

**W ofercie powinno być:**

Składanie ofert **do dnia 30.03.2021r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.03.2021r. o godzinie 12:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

**Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:**

1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ
4. Załącznik nr 6.1 do SIWZ

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Marta Sak