Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/06/22/203

Oborniki, dnia 05.09.2022r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/06/22

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na „Dostawa materiałów higienicznych przez okres 24 m-cy dla SP ZOZ Oborniki" opublikowanego w dniu 25.08.2022r. w BZP pod nr 2022/BZP 00319295/01.

ODPOWIEDZI

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 25 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet 1 poz. 4: czy Zamawiający wymaga 44 opakowań a'78 szt.?
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania 44 opakowań po 78 sztuk.

2. Pakiet nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluszki dla niemowląt posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w/w dokumentów, jednakże nie wymaga załączenia go do oferty.

3. Pakiet nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla niemowląt posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

4. Pakiet 1 poz. 7: czy Zamawiający wymaga, aby podkład wysokochłonny miał min. poziom chłonności 2000 g wg ISO 11948-1?
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

5. Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści koszulę jednorazowego użytku dla pacjenta, długość 110 cm, włóknina SMS o gramaturze 35 g/m2, kolor niebieski?
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pakiet 11 poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę o minimalnych parametrach: odporność na penetrację płynów 300 cm H2O, odporności na wypychanie na sucho 80kPa, na mokro 80kPa?
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 11, poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę bez przylepca?
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Pakiet 11, poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75 cm z przylepcem na krótszym boku, o gramaturze 56 g/m2?
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Pakiet 11, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm z przylepcem na krótszym boku?
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Pakiet 11, poz. 8: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?
    Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 11, poz. 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
    Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:
    serweta z przylepcem 1 szt. L2 240x150 cm
    serweta z przylepcem 1 szt. L2 180x170 cm
    serweta z przylepcem - przylepiec na dłuższym boku 2 szt. L2 90x75 cm

taśma medyczna 1 szt. Spunlace 50x9 cm
serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150 cm
serweta na stolik Mayo 1 szt. 145x80 cm
serwetki do rąk 2 szt. włók. kom. 40x20 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pakiet 20 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów pakowanych razem bluza+spodnie, niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic. Bluza posiada 3 kieszenie. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

14. Pakiet 24 poz. 1: czy Zamawiający wymaga: pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt a oraz b wzoru umowy na 0,5% lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

16. par. 6 ust. 1b: czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy na: "z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości niezrealizowanej części Pakietu"? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość

niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm – 170cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24, pozycja 1) pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze XL o chłonności co najmniej 2700 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24, pozycja 1) pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają system szybkiego wchłaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24, pozycja 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 8, poz. 9

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza: dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm oraz 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm, jednak dopuszcza podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm. Wykonawca powinien przeliczyć ilość opakowań zgodnie z rozdz. III pkt 7 SWZ, czyli do dwóch miejsc po przecinku.

23. Pakiet 8, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego Pakietu.

24. Pakiet 16

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Czy zamawiający dopuści maskę o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, gumki ok. 19 cm nierozciągnięte, , grubość gumki ok. 3 mm, maska z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 10-11 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

25. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści koszule włókninowe: 80% poliester + 20% wiskoza, w kolorze białym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

26. Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o poniższym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

2 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 serweta 100 x 100cm

1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm


1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

27. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o skladzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

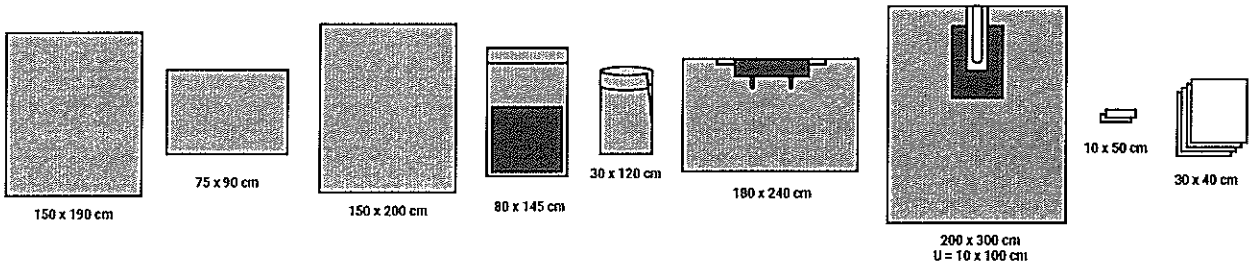

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

28. Pakiet 8 poz. 3 – 5, 8

Prosimy o doprecyzowanie jakich gramatur oczekuje Zamawiający

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury minimum 25g/m2

29. Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści poszwę 210 x 160 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła 50mb z przeliczeniem ilości wymaganych rolek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 10

Prosimy o doprecyzowanie jakich gramatur oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury minimum 25 g/m2.

33. Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze min. 60g/m2

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Pakiet 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

35. Pakiet 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepna w rozmiarze 75 x 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

36. Pakiet 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 200cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

37. Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 100cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

38. Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 200cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


39. Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach i składzie:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m2
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

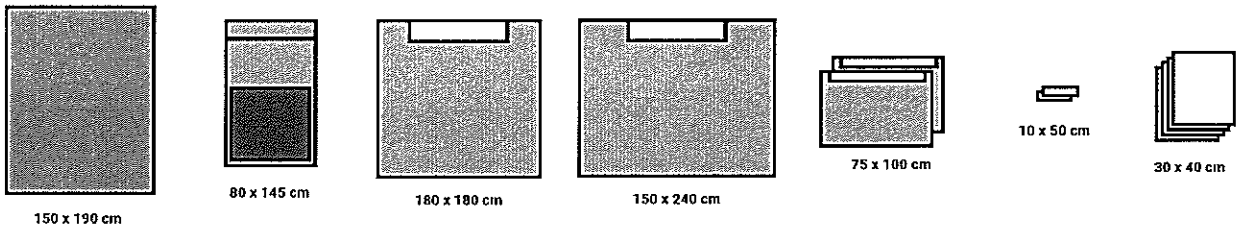

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

40. Dotyczy Pakietu 21

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego bez wzmocnienia zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze

67 g/m2- owinięty w papier krepowy

- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wyraża zgody.

41. Dotyczy Pakietu 21

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniem o następujących parametrach:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji | w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/m2- owinięty w papier krepowy
- odporność na wypychanie na sucho: min. 242 kPa
- odporność na wypychanie na mokro: min. 221 kPa
- pylenie 3,6 log 10 (liczba cząstek)
- odporność na przenikanie cieczy w obszarach wzmocnionych min. 175 cm H2O, w obszarze niewzmocnionym min. 22,5 cm H2O
- odporność na penetracje mikrobiologiczną na mokro 2,05 CFU/ 100 cm (norma 13795 określa wymagania dla obu stref: =< 300, czyli max. 300 CFU/ 100 cm) - kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/m2- owinięty w papier krepowy
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wyraża zgody.

42. Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo o odporności na penetrację płynów min. 170 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho/ mokro min. 170 kPa w strefie wzmocnienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

43. Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem o średnicy 8 cm, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

44. Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem o średnicy 6 cm, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

45. Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

46. Pakiet nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

47. Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

48. Pakiet nr 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

49. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca o wymiarach 80 x 145 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

50. Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

51. Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

52. Pakiet nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

53. Pakiet nr 3

Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej wykonanej z włókniny poliestrowej i folii poliuretanowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

54. Pakiet nr 5

Pakiet nr 5

Pozycje 1 i 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta polietylenowa pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

55. Pakiet nr 6

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
1 x serweta extra wzmocniona, U przylepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 cm
1 x serweta wzmoniona przylepna z warstwą przylepną 100 cm, 170 x 300 cm
1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 150 x 190 cm
1 x stokineta dwuwarstwowa 35 x 120 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet nr 11

Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę bez taśmy lepnej w rozmiarze 90 x 150 cm – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

57. Pytanie 1:

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył czas realizacji zamówienia. Punktowany termin dostaw Zamawiający wyznaczył od 3 do 7 dni. W przypadku wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 23, tak krótki termin dostawy niestety jest trudny do spełnienia ze względu na każdorazowe ustalenia przy zamówieniu, a mianowicie dotyczące kolorów, czy rozmiarów. Wykonawca każde zamówienie musi produkować na bieżąco – według zapotrzebowania.

Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, zmieni minimalny punktowany termin dostawy dla

Pakietu nr 23 na co najmniej 10 dni roboczych, natomiast maksymalny na 15 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmieni termin dostawy dla Pakietu nr 23 na 10 – 15 dni.

58. Pytanie 2:

Zamawiający wymaga odzieży zgodnej z normą PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. Z punktu widzenia epidemiologii, co jest bardzo ważne w obecnych czasach, bardzo istotnym, a pominiętym parametrem opisanym w ww. Normie jest czystość mikrobiologiczna.

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne, wymaga aby cały asortyment z Pakietu nr 23 był w pełni zgodny z normą PN-EN 13795, co będzie potwierdzone przedstawionymi na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

59. Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 odzież tj.: bluzy, spodnie i sukienki o wysokiej, lecz nie potwierdzonej wynikiem badania przepuszczalności powietrza, o składzie 48% bawełna, 52% poliester z tolerancją +/- 3% oraz o gramaturze 130 g/m2 +/- 3%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

60. Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 fartuchy wykonane w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze max. 135 g/m2?

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

61. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 15x250cm z wycięciem U 7x70cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP z dodatkowym padem chłonnym 50x50cm i organizatorami przewodów, chłonność w strefie krytycznej 563ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

62. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 15x250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada osłon na kończyny w asortymencie.

63. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojedynczych 700 sztuk osłony czy 700 opakowań a'2szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 700 opakowań po 2 sztuki.

64. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej jednokomorowej 30x40cm wyposażonej w 0,5centymetrowoą zakładkę stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

65. Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej 9x50cm wykonanej z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 pokrytej klejem hipoalergicznym zabezpieczonym papierem silikonowanym z figerliftami pozwalającymi na oderwanie w rękawiczkach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

66. Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm wykonanej z piaskowanej folii PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85 z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Zgodna z normą 13795-1:2019. Odporność na przenikanie płynów 165cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

67. Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Zgodnej z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

68. Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety 50x60cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Zgodnej z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

69. Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety 50x60cm z taśmą lepną na dłuższym boku, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Zgodnej z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

70. Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 5Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety 75x90cm z taśmą lepną na dłuższym boku, wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 70g/m2. Zgodnej z normą EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

71. Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

72. Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90x120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

73. Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

74. Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

75. Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw serwet uniwersalny I (serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm, 1 samoprzylepna serweta

operacyjna 150 x 240 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180x180 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, 2 ręczniki celulozowe 30,5x34 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Serweta na stolik Mayo wykonana z folii piaskowanej PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na przenikanie płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie n sucho/mokro 168/168kPa

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U" 20 x 85 cm z padem chłonnym

50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Serweta na stolik Mayo wykonana z folii piaskowanej PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na przenikanie płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie n sucho/mokro 168/168kPa

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U" 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Serweta na stolik Mayo wykonana z folii piaskowanej PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na przenikanie płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie n sucho/mokro 168/168kPa

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii piaskowanej PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m (łączna gramatura 140g/m2). Materiał serwet zgodny z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. Chłonność 458%

Opakowanie jednostkowe Tyvec folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Serweta na stolik Mayo wykonana z folii piaskowanej PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m (łączna gramatura 140g/m2). Materiał serwet zgodny z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie płynów 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. Chłonność 458%

Opakowanie jednostkowe Tyvec folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

81. Pytanie nr 19 – dotyczy wymogu zgodnośći z normą AAMI PB70

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia wnosimy o odstąpienie od wymogu obłożeń zgodnych z normą AAMI PB70.

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795:2019, natomiast norma AAMI PB70 jest normą amerykańską, niezharmonizowaną z przepisami europejskimi, dlatego też wymóg oferowania asortymentu z w/w normą jest bezzasadny i znacznie ogranicza zasadę konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

82. Pytanie nr 20 – dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Żaden z załączników nie określa żadnych wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. "Palność" opisana w PN-EN 13975 zobowiązuje producentów obłożeń i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako "paliwo" podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the

Flammability of Clothing Textiles" - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission" (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia.

83. Pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi:

1 x sterylna serweta chirurgiczna (obłożenie chirurgiczne) w kształcie litery T o wymiarach 175/250x300cm, z prostokątnym otworem 38x32cm, wypełnionym folią chirurgiczną, z podłączonym workiem do przechwytywania płynów 100x8cm ze sztywnikiem, podłączeniem do ssaka i organizatorem przewodów, pozwalającym na zachowanie czystości i uporządkowania licznych przewodów od aparatury operacyjnej

1 x serweta chirurgiczna służąca do owinięcia zestawu, o wymiarach 150x190cm

1 x kocyk dla noworodka o wymiarach 90x120cm

1 x taśma samoprzylepna 9x49cm

4 x ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm

1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm ze wzmocnieniem 65x85cm

1 x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 50 x 50 cm

Pakowane w dużym kartonie zbiorczym, zawierającym 2 dyspensery po 4 zestawy – 8 zestawów w kartonie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

84. Pakiet 15 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi:

1. Serweta wzmocniona na stolik 150x190 cm, służąca do owinięcia zestawu, wykonana z włókniny 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów -1 szt.

2. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem dł. 6 cm, sposób złożenie i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Włóknina 3

warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej 55cm H2O, rozmiar XL - 3 szt.

3. Rękawice chirurgiczne lateksowe Biogel 6,5 - 1 szt.

4. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85 cm, włóknina wiskozowa 27g/m2, Folia PE 60 mikronów, odporna na przenikanie cieczy i rozerwań - 1 szt.

5. Miska 250 ml, niebieska - 1 szt.

6. Tupfer z gazy opatrunkowej bardzo duży 20-nitkowy gr.6 – 5 szt.

7. Ostrze chirurgiczne nr 10 CS - 1 szt.

8. Kompres gazowy 10x10 gaza 17 nitkowa 12 warstwowa znacznik Rtg - 20 szt.

9. Kompres laparatonijny z tasiemką 50x60cm Rtg, 4 warstwowe - 5 szt.

10. Opatrunek pooperacyjny Mepilex Border o wym. 10x30 cm, opatrunek chłonny piankowy 1 szt.

11. Kocyk dziecięcy biały o wym. 90x120cm 1 szt.

12. Obłożenie chirurgiczne do cesarskiego cięcia o wymiarach 175/250x300cm z otworem wypełnionym folią o wymiarach 38x32cm wyposażony w sztywnik – 1 szt.

Zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu tyvec z klapką 5 mm ułatwiający otwieranie, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy opis składu zestawu, nazwa, nr lot, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi.

Zestaw zgodny z PN EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

85. Pytanie 1

Dotyczy pakiety 3 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwową samoprzylepną owym. 200 x 150 cm z wycięciem „U" o wym. 7 x 65 cm ze wzmocnieniem (warstwa chłonna o wym. 70 x 100cm) w strefie krytycznej

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

86. Pytanie 2,

Dotyczy pakiety 3 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o wymiarach 14 x 250 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

87. Pytanie 3,

Dotyczy pakiety 3 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 75 x 120 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

88. Pytanie 4,

Dotyczy pakiety 3 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 40 x 35 cm bez sztywnika? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

89. Pytanie 5,

Dotyczy pakiety 3 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną o wymiarach 9 x 49 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

90. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładanej przez głowę, z krótkim rękawem, długość: 92 cm, w kolorze białym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

91. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładanej przez głowę, z krótkim rękawem, szerokiej, dającej możliwość swobodnego stosowania u pacjentów otyłych, o długości 105 cm, szerokości 90cm (obwód 180 cm), w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

92. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładanej przez głowę, długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm (obwód 140 cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

93. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

94. Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U o wymiarach 150x250cm z wycięciem o wymiarach 7cm x 70cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2, w strefie krytycznej wyposażonej we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, dostępną w zestawie z serwetą wzmocnioną na stół instrumentalny stanowiącą owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm o poniższych parametrach:

- odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N
- odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O
- współczynnik pylenia 3.4log10
- chłonność wzmocnienia min. 680%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

95. Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

96. Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 70x120cm, pakowaną a'2szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

97. Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

98. Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10x50cm wykonaną z włókniny typu spunlance 68g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

99. Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm


1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw.

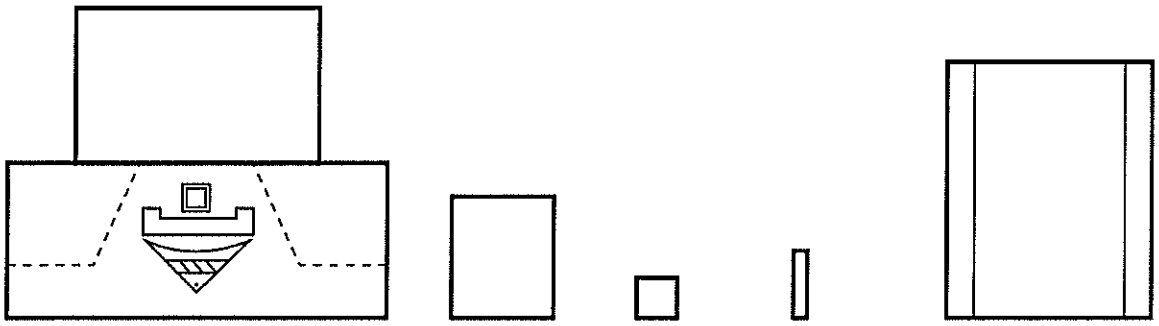

160/240x180cm 1szt./pc. | **75x90cm** 1szt./pc. | **30x30cm** 4szt./pcs | **10x50cm** 1szt./pc. | **150x190cm** 1szt./pc.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

100. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,

1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm

4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,


1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serweta wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m2.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 35 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

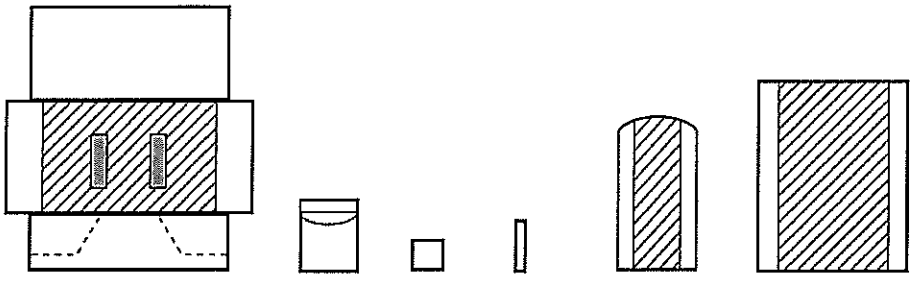

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

101. Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm

4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,


1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm

Serweta wykonane z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m2

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 35 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

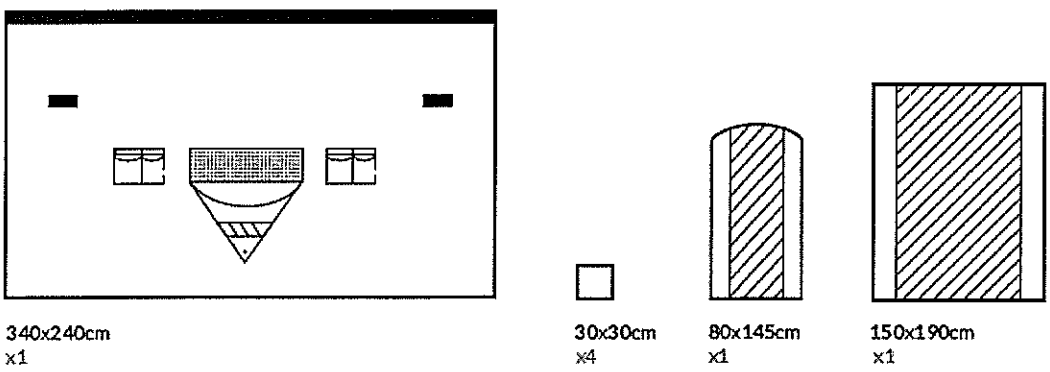

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

102. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2


1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

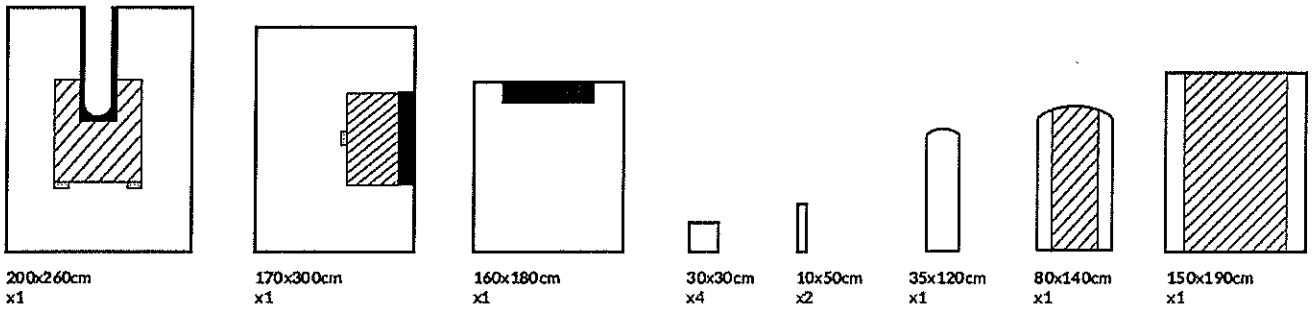

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

103. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni nieprzemakalny wykonany z polietylenu, przezroczysty, mleczny, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

104. Pakiet 8, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

105. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch o kroju standardowym, chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z dzianiny, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

106. Pakiet 8, pozycja 1, 2, 3, 5, 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

107. Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

108. Pakiet 8, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

109. Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

110. Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 210 cm x 160 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

111. Pakiet 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne papierowe w rolce z perforacją co 37,5 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

112. Pakiet 10, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

113. Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki z rozcięciem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

114. Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2; osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H2O, odporności na wypychanie na sucho 108 kPa oraz na mokro 95 kPa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

115. Pakiet 11, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

116. Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

117. Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

118. Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

119. Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

120. Pakiet 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

121. Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

122. Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2, : w strefie krytycznej wyposażona w dwa wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

1 x serweta o wymiarach 175 cm x 240 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym o średnicy 3 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów.

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma typu rzep 2x22cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

123. Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

124. Pakiet 14, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



150x180cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

125. Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

126. Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 150cm x 190cm, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie chłonnej - 63 g/m2; serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia); warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, o chłonności serwety 350%.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

127. Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego oraz dodatkoww zapięcie w okolicy karku na rzep, ze szwami wykonanymi techniką ultradźwiękową; oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

128. Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, w opakowaniu a'50 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

129. Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

130. Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

131. Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

132. Pakiet 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

133. Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, z rękawami krótkimi zakończonymi obszyciem, wyposażoną w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi) oraz dekolt z przodu z zapięciem na biały nap., z wszytą metką informującą o rozmiarze, dół bluzy obszyty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

134. Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę w rozmiarach S- XXL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

135. Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, wiązane na troki w pasie, wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap, z wszytą metką informującą o rozmiarze, nogawki obszyte?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

136. Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarach S- XXL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

137. Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach?

- jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm,
- 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego
- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep
- szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu
- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania
- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m²
- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm

- odporność na przenikanie cieczy 226 cm H2O,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 268,9 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 141,5 N.
- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej
- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3
- dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

138. Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach?

- jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
- wzmocniony na przedmamieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2
- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm
- 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego
- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep
- szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu
- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania
- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m²
- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm
- odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej
- pakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej.
- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3
- dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

139. Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, z wkładką chłonącą pot 5-warstwową wykonaną z włókniny typu Spunlace

38g/m2, oddychający, wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm, w opakowaniu a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, dostępny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

140. Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, dostępny w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

141. Pakiet 22, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

142. Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką zawierającą lateks, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

ZMIANY ZAPISÓW SWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2022r. poz. 25 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ:

1. W rozdz. XIV pkt 1 jest:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Cena oferty - 90 % - max 90 pkt

2) Termin dostawy - 10% - max 10 pkt

Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt;

gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu: **od 3 do max 7 dni od złożenia zamówienia.**

Powinno być:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Cena oferty - 90 % - max 90 pkt

2) Termin dostawy - 10% - max 10 pkt

Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt;

gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) od 10 do 15 dni od złożenia zamówienia (dla Pakietu nr 23)

b) od 3 do max 7 dni od złożenia zamówienia (dla pozostałych Pakietów)

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki :

SWZ po modyfikacji

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak